POPO 用ハーネスライトの装着方法

202201

各部の名称

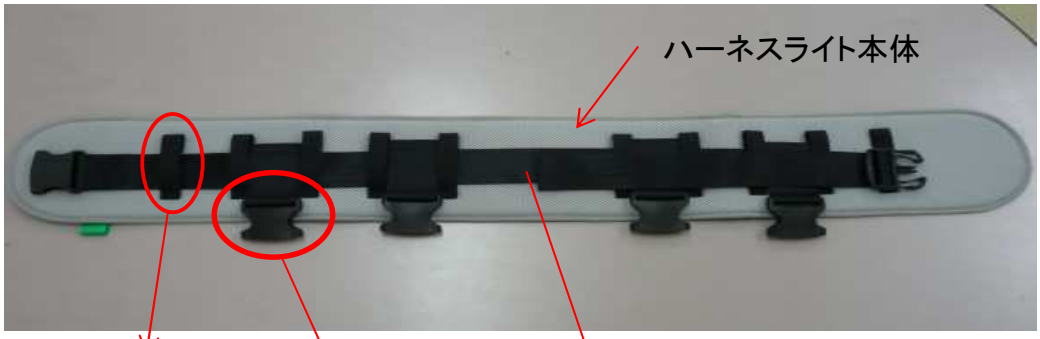

クロッチベルト

POPO 用ラダーベルト

サイズ表

腸骨周り適合目安

S サイズ　72cm～86cm

M サイズ　86cm～100cm

L サイズ　100cm～114cm

※目安寸法ですので、体型・体格により変わってきます。現物で確認していただく事をお勧めいたします。

装着手順

1

POPO用ラダーベルトをベルトに通します。
ループとループの間ではどこでも使用することができます。
体型・体格に合わせてラダーベルトの位置を調整して下さい。

2

クロッチベルトを差し込みます。
注意：バックルには裏と表がありますのでご注意下さい。裏側は差込みが出来ません。

差し込む方向はありません

【車椅子（座位姿勢）でのハーネスの着け方】

1

車椅子のブレーキを掛けます。
体を前に少し傾けて、ハーネスを後ろから差し込みます。

2

腸骨の辺りで装着します。

3

②引っ張ります。

① 少し緩ませます。

ベルトをしっかり締め付けます。
締め付けが出来ない場合は、①少しベルトを緩ませ②引っ張ります。

4

クロッチベルトを前方へ引っ張り出します。
そのまま大腿部の下に通し、バックルに差し込みます。

○　　×

注意：クロッチベルトにねじれがないように注意してください。

5

装着完成図

【ハーネスライトをPOPOに装着する方法】

1

車椅子のブレーキを掛けPOPOのアームフックにラダーベルトを引っ掛けます。
上昇ボタンを押し、ラダーベルトにテンションがかかった時に一旦上昇を止め、
完全に引っ掛かっているかを確認して下さい。

2

確認後、上昇ボタンでさらに上げて行きます。
その際、POPOを少し前方へ動かしながら、上昇して行きますと立ち上がりやすくなります。

車椅子へ降ろす際は、反対の手順で行って下さい。

ご注意

・耐荷重は100kgとなります。体重が100kgを超える方には、使用できません

お手入れ

・吊り具は消耗品です。破れやほつれがないことを確認してから、ご使用して下さい。発見した場合、直ちに使用を中止し、お求めになられた販売店にご連絡ください
・消毒は弊社商品じょきん娘を推奨いたします。もしくは、5%グルコン酸クロルヘキシジン溶液を100倍希釈した溶液に浸漬してください。
・洗浄は中性洗剤をご使用の上、手洗いをお薦めします。

MORITOH CORPORATION 株式会社モリトー

介護リフト つるべ TSURUBE

『安・楽・満』

安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します!

■ 製造販売元　MORITOH CORPORATION 株式会社モリトー

■ 本社　〒491-0074　愛知県一宮市東島町 3-36
TEL（0586）71-6151　FAX（0586）72-4555

■ 札幌営業所　〒063-0870　北海道札幌市西区八軒十条東 1-1-57-101
TEL（011）708-5200　FAX（011）708-5201

■ 仙台営業所　〒981-1102　宮城県仙台市太白区袋原 6-9-22
TEL（022）302-7914　FAX（0586）72-4555

■ 埼玉営業所　〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-6-103
TEL（048）753-9393　FAX（03）3777-1649

■ 東京営業所　〒143-0025　東京都大田区南馬込 4-16-3
TEL（03）3777-1648　FAX（03）3777-1649

■ 中部営業所　〒491-0074　愛知県一宮市東島町 3-36
TEL（0586）71-6151　FAX（0586）72-4555

■ 大阪営業所　〒577-0016　大阪府東大阪市長田西 2-6-2-B
TEL（06）6785-7202　FAX（06）6785-7203

■ 岡山営業所　〒700-0954　岡山県岡山市南区米倉 30-102
TEL（086）259-2910　FAX（0586）72-4555

■ 福岡営業所　〒811-1204　福岡県那珂川市片縄東 1-12-1
TEL（092）953-1892　FAX（092）953-1973

■ 信濃大町研修センター　〒398-0001　長野県大町市大字平 22393
TEL（0261）23-1678

お客様相談室　フリーダイアル　0120-65-2525
お問合せ［e-mail］　info@moritoh.co.jp
ホームページ ： http://www.moritoh.co.jp

いつでも、どこでも、だれにでも 安・楽・満を提供しつづけることが大切です。
我々も含めたすべての人々が、安らぎと楽しみを満喫できることを願っています。